

## Avis de projet de marché (APM)

RNCan 500055086

### Accord commercial:

- Accord de libre-échange Canadien (ALEC)
- Accord de libre-échange Canada-Corée du Sud (ALECCS)
- Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC)
- Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALECCo)
- Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALECH)
- Accord de libre-échange Canada-Panama (ALECPa)

### Procédure d'appel d'offre :

À tous les fournisseurs pré-qualifiés dans le **catégorie (instruments de mesure et d'observation des flux liquides et gazeux) et sous-catégorie (débitmètres)**

**Stratégie d'approvisionnement concurrentiel** : La soumission qui répond aux critères techniques obligatoires avec le **prix global le plus bas**.

**Entente sur les revendications territoriale globale** : Non

**Nature du besoin** : **Système de distribution en hydrocarbures C5+**

### Autorité contractante :

Raymond Thai  
[raymond.thai@canada.ca](mailto:raymond.thai@canada.ca)  
343-543-7427

CETTE DEMANDE EST RÉSERVÉ POUR LES TITULAIRES DE L'ARRANGEMENT EN MATIÈRE D'APPROVISIONNEMENT # E60PV-19EQUI SEULEMENT, POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT, DE PIÈCES ET ACCESSOIRES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES DE LABORATOIRE ET SCIENTIFIQUE.

Seulement les fournisseurs présentement pré-qualifiés sur l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI ont été invité à soumettre une soumission.

Conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement, cet avis est publié sur Achat et Vente Canada pour une période de 40 jours civils. La date de clôture publiée sur cet avis indique sa durée de publication. Pour connaître la date de clôture de toute demande de soumissions dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement, les fournisseurs invités doivent se reporter aux documents de sollicitation.

Les fournisseurs qui n'ont pas d'arrangement en matière d'approvisionnement avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique ne peuvent soumissionner. Toutes offres reçues de fournisseurs non pré-qualifiés dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ne sera pas évaluée.

Les fournisseurs peuvent, à tout moment, se qualifier sous l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique. Les fournisseurs intéressés doivent télécharger le document de sollicitation E60PV-19EQUI/C sur [achatsetventes.gc.ca](http://achatsetventes.gc.ca) et soumettre une réponse selon les exigences de la demande d'arrangement en matière d'approvisionnement.

**Exigence :**

**Ressources Naturelles Canada (RNCAN) – Secteur des technologies énergétiques** a besoin d'un **système de distribution en hydrocarbures C5+**. Ce système doit évaporer et contrôler le débit des hydrocarbures C5+. Comme le montre la figure A1, les hydrocarbures seront stockés sous forme liquide dans des récipients à pression à l'intérieur d'une armoire pour produits inflammables. Le système doit avoir la capacité de contrôler le débit de chaque espèce simultanément et de les convertir en forme gazeuse. Le système requis, décrit en rouge sur la figure A1, a été esquissé à des fins de démonstration seulement; le système proposé peut être différent (par exemple, en nombre de régulateurs de débit ou d'évaporateurs) de celui illustré. Les gaz évaporés seront ensuite envoyés dans une conduite chauffée vers un collecteur-distributeur où ils seront mélangés avec plusieurs autres hydrocarbures gazeux (C1-C4) et des gaz inertes et ensuite brûlés dans un brûleur de laboratoire.

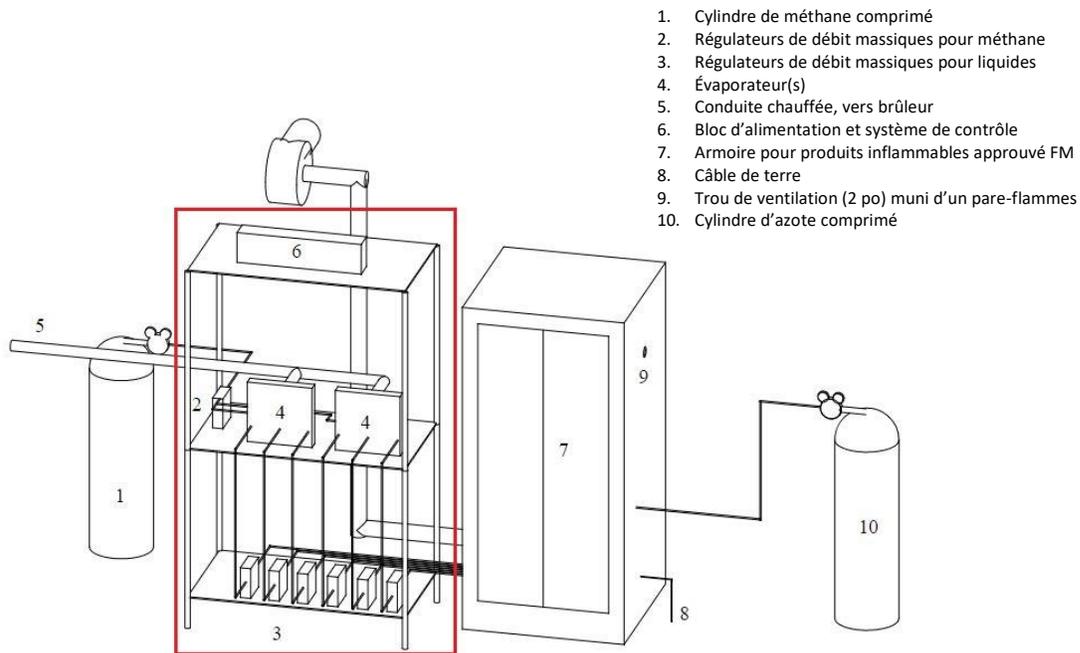


Figure A1: Esquisse d'un système de stockage et de distribution d'hydrocarbures

**Les critères techniques obligatoires sont :**

Le soumissionnaire répondant déjà titulaire d'un arrangement en matière d'approvisionnement pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, qui répond au critères techniques obligatoires avec le prix global le plus bas sera recommandé pour l'attribution du contrat.